



УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР  
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,  
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027  
И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2026. 03. 06 № 1/156  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ  
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ  
БАЙГУУЛЛАГУУДАД

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.


Үнийн саналыг 2026 оны 03 дугаар сарын 09-ний 12 цаг хүртэл хүлээн авна.

Майл хаяг: [procurement@fchm.edu.mn](mailto:procurement@fchm.edu.mn)

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар 103 тоот

Хавсралт 1 хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

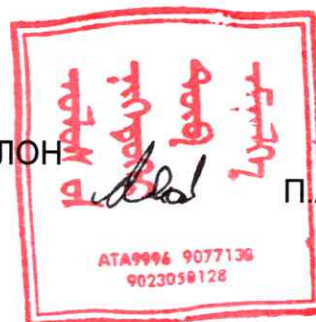

П.АНХТУЯА

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий захирлын 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 111/2026 дугаар албан бичгийн хавсралт



№	Эмнэлгийн хэрэгсэл, хиймэл цорго, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил	Хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Шээлгүүрийн стент (бөөрөнд байрлах хэсгийн төгсгөл нь цагираг, нөгөө үзүүр нь шулуун)	6 fr -60 sm дээш урттай	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гуурсны дээд төгсгөл нь гахайн сүүлэн эргэлттэй, доод төгсгөл нь шулуун, шээлгүүр болон бөөрөнд байрлах хэсэг нь нүхтэй байна</li> <li>2. Богино хугацаанд хэрэглэгдэх (1-12 сар хүртэл)</li> <li>3. Стент гуурс байрлуулагч нь түгжигддэг</li> <li>4. Гидропилик бүрхүүлтэй тул усыг өөртөө татах нь илүү, ус хүрэхээр гулсамтгай болдог, уян</li> <li>5. Шингэнийг амархан шингээгч микротин давхаргатай</li> <li>6. Thermosensitive материалтай</li> <li>7. Хэмжээ нь 6F ба 7F диаметртэй байна.</li> </ol>	30
2	Уян чиглүүлэгч	0.38*150 см, шулуун	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нитинол материалаар хийгдсэн</li> <li>2. Гидрофиль бүрхүүлтэй</li> <li>3. Бага үрэлтэт полимер бүрхүүлтэй</li> <li>4. Уян үзүүрийг эмч өөрийн хүссэн чиг рүү чиглүүлэх боломжтой</li> <li>5. Үзүүр хэсгийн 3см хүртэлх нь уян, түүнээс хойшхи хэсэг нь илүү барьцтай, нугаларахгүй /Stiff/ материалтай</li> <li>6. Гогцоорохгүй</li> <li>7. Рентгенд мэдрэмтгий</li> <li>8. СТ болон MRI-аар харагдах чадвартай байх</li> <li>9. Хүний биед гэмтэл учруулахгүй</li> </ol>	60

----- ооо ООО ооо -----