



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026. 03.23 № 1/591
танай _____-ны № _____-т

**ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 03 дугаар сарын 24-ний 12 цаг хүртэл хүлээн авна.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар 103 тоот

Хавсралт 1 хуудастай.


ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

142260974

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны 07 дугаар сарын 23-ны
едрийн 1591 дугаар албан бичгийн хавсралт

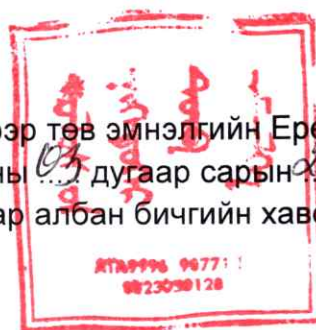

Үнийн санал

№	Эмнэлгийн хэрэгслийн нэршил	Хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	2 хөндийн пейсмекер төхөөрөмж /MRI боломжтой/		Электрод холболт нь IS1 стандарттай, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) боломжтой, MRI-д оношилгоонд зориулсан тохиргоотой. Тосгуурын фибрилляцийг үүсэх үед дарангуйлан арилгах горимтой, пейсмекер хамааралтай болон хамааралгүйгээр аюултай хэм алдагдал үүссэнийг бүртгэн авч 2 ба түүнээс дээш минутын бичлэгийг хадгалдаг байх; Үйлдвэрийн тохиргоогоор ажиллах хугацаа 12 ба түүнээс дээш жил, үйлдвэрлэлийн баталгаат хугацаа 5 ба түүнээс дээш жил, мэдрэг байдлын тохиргоо болон цочроох байдлын тохиргоо нэг туйлт, хоёр туйлт боломжтой байх, баруун тосгуур, ховдлыг цочроох вольтын хэмжээг төхөөрөмж өөрөө автоматаар шалгаж, өөрийгөө тохируулах чадвартай байх, ховдлын өөрийн агшилтыг дэмжих алгоритмтай, зүрхний суурь цохилтын тоо ба пейсмекерээр удирдаж эхлэх суурь цохилтын тоог өөр өөрөөр тохируулах боломжтой байх, PSA шалгагчтай байх.	2
2	Тосгуурын электрод		Шулуун хэлбэртэй, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) хийх боломжтой, хэмжээ 6F-ээс ихгүй, 53 см дээш 3 төрлийн уртын сонголттой, идэвхтэй бэхэлгээтэй, polyurethane, silicone холимог бүрхүүлтэй, электродын оролт IS1 стандарттай, электродын уртын тэмдэглэгээтэй, стеройдын хэсэгтэй, хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэхэд зориулсан бэхэлгээ хийх хамгаалалтын хэсэгтэй, биполяр туйлтай байх.	2
3	Ховдлын электрод		Шулуун хэлбэртэй, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) хийх боломжтой, хэмжээ 6F-ээс ихгүй, 58 см доод тал нь 4 төрлийн уртын сонголттой, идэвхтэй бэхэлгээтэй, polyurethane, silicone холимог бүрхүүлтэй, электродын оролт IS1 стандарттай, электродын уртын тэмдэглэгээтэй, стеройдын хэсэгтэй, хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэхэд зориулсан бэхэлгээ хийх хамгаалалтын хэсэгтэй, биполяр туйлтай байх.	2
4	Электродын хатгалтын интродюсер /ширхгээр/		Гүний венийн хатгалтын зүү, тариур, чиглүүлэгчийг багтаасан багц байх, тэлэгч нь интродюсертэй тогтвортой бэхлэгдэх түгжээтэй, 6F, 7F, 8F, 10F, 11F, 12F өргөний сонголттой, 14 см урттай, урагдан салдаг байх.	4
5	Түр зуурын электрод пэйсмекер		Түр зуурын пейсмекерийн үүсгүүр Нэг хөндийн түр зуурын пейсмекер Үндсэн үзүүлэлт • Үндсэн горим: S00, SSI, SST • Зүрхний цохилт: 30 - 250 ppm • Өдөөлтийн далайц 0.1 - 17 V • Тосгуурын тахиарритмийг эмчлэх brush rate-тай байх • Хяналт тохируулга хийх боломжтой • Аюулгүйн дохио өгдөг байх /Батерейны цэцэг бага, электродын эсэргүүцэл их үед/ • Түр зуурын янз бүрийн электродуудтай холбогдох кабелийн сонголттой байх • Батерейтай байх	2